CHV AniCura Aquivet
Parc d'activités Mermoz, 19 Av. de la Forêt, 33320 Eysines
Tél : 05 56 95 01 01
contact.aquivet@anicura.fr
www.anicura.fr/chv-aquivet/

PROPRIETAIRE:	LPEA	**EXAMEN:**	ECHOGRAPHIE
ANIMAL:	MADO	**DATE:**	28/02/2025
VETERINAIRE REFERENT:		**INTERVENANT:**	FRANCK DURIEUX

COMPTE-RENDU D'EXAMEN ECHOGRAPHIQUE


Technique :
Un examen complet des structures abdominales est réalisé : Appareil digestif (estomac, intestin grêle et côlon) et ses glandes annexes (foie, voies biliaires, pancréas), Appareil uro-génital, Glandes surrénales, Système réticulo-endothélial (nœuds lymphatiques, rate), Réseaux vasculaires principaux (en particulier : aorte, veine cave caudale, veine porte).


Description :


Synthèse/conclusion :

Absence d'anomalie de l'abdomen.

Dr Franck Durieux
Vétérinaire, N° d'ordre 12726
Diplômé du collège européen d'imagerie médicale vétérinaire (ECVDI)
Spécialiste en imagerie médicale vétérinaire

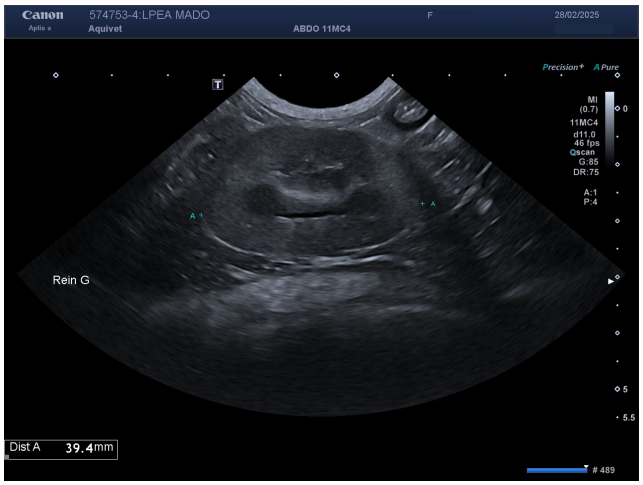

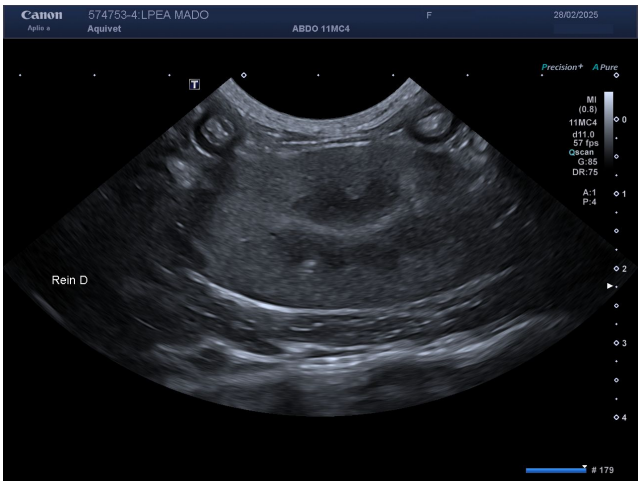

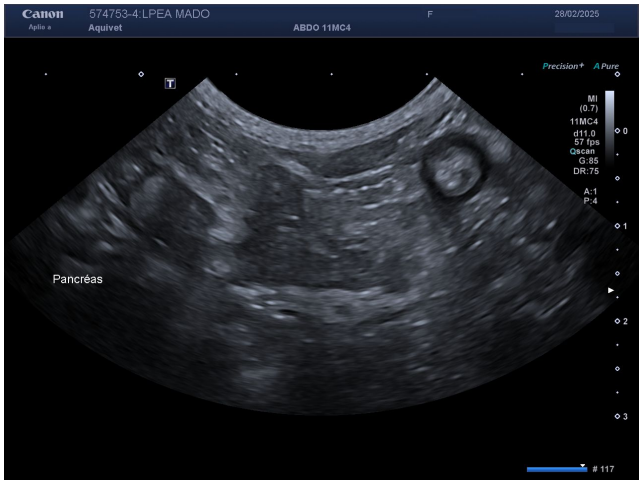
Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO 11MC4
Precision+
A Pure
MI
(0.7)
11MC4
d11.0
57 fps
Qscan
G:85
DR:75
A:1
P:4
Pancréas
117


Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO 11MC4
Precision+
A Pure
MI
(0.7)
11MC4
d11.0
57 fps
Qscan
G:85
DR:75
A:1
P:4
Foie
119


Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO 11MC4
Precision+
A Pure
MI
(0.7)
11MC4
d11.0
57 fps
Qscan
G:85
DR:75
A:1
P:4
Vesicule
509


Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO 11MC4
Precision+
A Pure
MI
(0.7)
11MC4
d11.0
57 fps
Qscan
G:85
DR:75
A:1
P:4
papille
458


Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO 11MC4
Precision+
A Pure
MI
(0.6)
11MC4
d11.0
57 fps
Qscan
G:85
DR:75
A:1
P:4
Intestin
76



Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO-L18
Precision+
A Pure+
MI
(1.6)
18L7
d14.0
32 fps
Qscan
G:88
DR:80
A:3
P:4
Intestin
227


Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO-L18
Intestin
311


Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO-L18
510


Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO-L18
Surrenale G
Dist A 3.4mm
511


Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO-L18
Surrenale D
Dist A 3.8mm
500

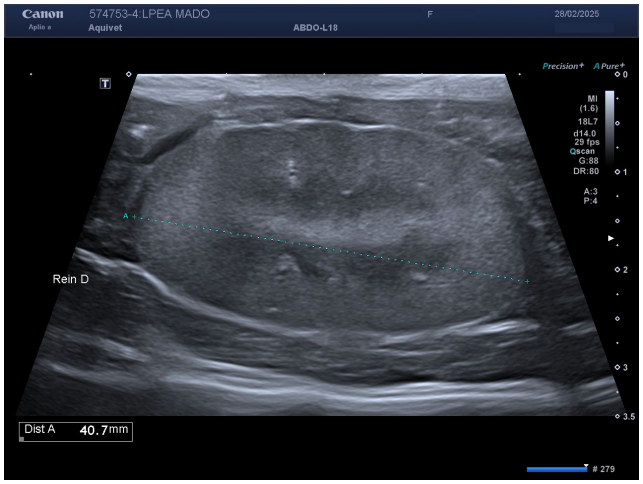
Canon
574753-4:LPEA MADO
F
28/02/2025
Aquivet
ABDO-L18
Rein D
Dist A 40.7mm
279